



# NEWARE BTS-4000 技术规格

## 技术指标:


设备型号: CE-4048-5V20A 电池检测设备

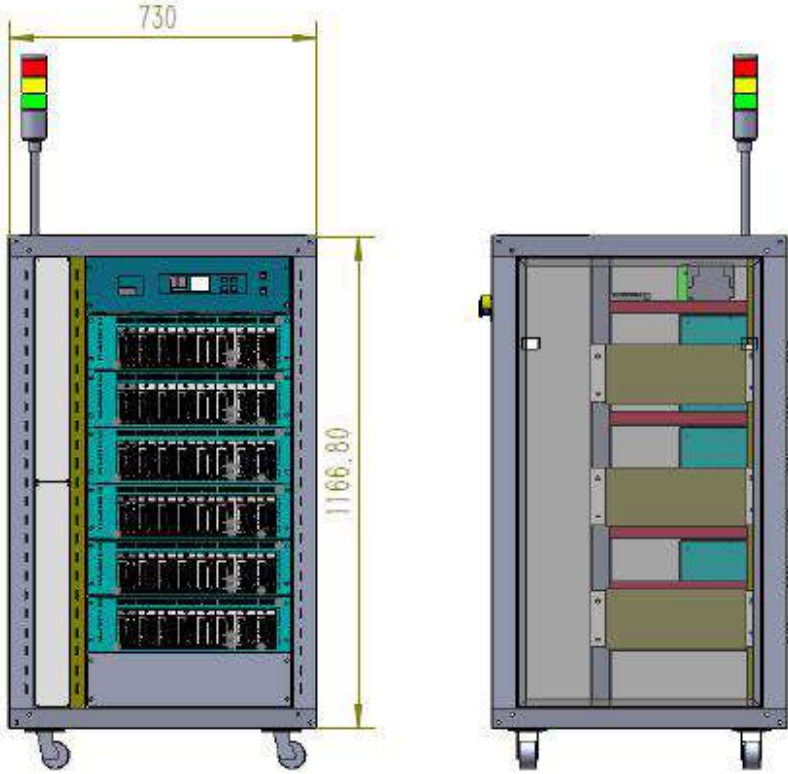
设备物料编码: CE-4048-5V20A

指标项目		指标参数
输入电源		AC 380V ±10% / 50Hz
输入有功功率		6857W
输入阻抗		≥100kΩ
分辨率		AD: 16bit; DA: 16bit
电压	每通道测量范围	充电: 0.025V~5V 放电: 0.025V~5V
	最低放电电压	0V
	精度	± 0.05% of FS
	稳定度	± 0.05% of FS
电流	每通道输出范围	充电: 0.1A~20A 放电: 0.1A~20A
	精度	± 0.05% of FS
	恒压截止电流	0.04A
	稳定度	± 0.05% of FS
功率	单通道输出功率	100W
	稳定度	±0.1% of FS
时间	电流响应时间	最大电流上升时间<40ms
	工步时间范围	≤ (365*24) 小时/工步 时间格式支持00: 00: 00.000(h、min、s、ms)
数据记录	记录条件	时间范围ΔT: 100ms
		最小电压间隔: 10mV
		最小电流间隔: 40mA
记录频率	10Hz	
充电	充电模式	恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电
	截止条件	主通道: 电压、电流、相对时间、容量、-ΔV
放电	放电模式	恒流放电、恒功率放电、恒阻放电
	截止条件	主通道: 电压、电流、相对时间、容量
脉冲模式	充电	恒流模式、恒功率模式
	放电	恒流模式、恒功率模式
	最小脉冲宽度	500ms
	脉冲个数	单个脉冲工步支持32个不同的脉冲
	充放电连续切换	一个脉冲工步可以实现从充电到放电的连续切换
	截止条件	电压、相对时间
DCIR测试	支持自定义取点进行DCIR的计算	
节能效率	>85%(与常规设备比较)	
循环	循环测试范围	1~65535次

	单循环工步数	254
	循环嵌套	具有嵌套循环功能，最大支持3层嵌套
保护		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 掉电数据保护</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 具有脱机测试功能</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 可设定安全保护条件，可设置参数包括：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 具有防反接功能</li> </ul>
通道特点		恒流源与恒压源采用双闭环结构
IP防护等级		防护等级IP20
通道控制模式		独立控制
电压电流检测采样		四线制连接
噪声		<85dB
数据库		采用 MySQL 数据库集中管理测试数据
上位机通讯方式		基于TCP/IP协议
服务器磁盘配置		500GB
数据输出方式		EXCEL20032010、TXT
服务器操作系统		Windows7
通信接口		网口

**设备工作环境要求**

指标项目	指标参数
工作温度范围	0°C~40°C（在 25±10°C 范围内，保证测量精度：精度漂移 0.005% of FS /°C）
存储温度范围	-10°C~50°C
工作环境相对湿度范围	≤70% RH（没有水汽凝结）
存储环境相对湿度范围	≤80% RH（没有水汽凝结）
夹具类型	线鼻子或聚合物夹或鳄鱼夹
夹具图片	
	图片仅供参考，以实物为准，

指标项目	指标参数
设备图片	 <p>尺寸：730*700*1167mm 重量≈200kg 图片仅供参考，以实物为准。</p>
备注：不兼容带具有软起功能的保护板电池的测试	